


発行番号	A9999999		
発行日	2021年9月13日		
<b>検査成績書</b>			
品名	デジマチックキャリバ	検査年月日	2021年9月10日
符号	CD-15PS	温度	20.5°C
コード No.	500-622	湿度	50%
製造番号	\$\$\$\$\$\$	検査規格	ミツトヨ規格
測定範囲	0~150mm		
最小表示量	0.01mm		
外観	能: 良・不良		
機能	能: 良・不良		
性能:			
		誤差(mm)	
測定長(mm)	最大許容誤差(mm)	外側	内側
0	±0.02	0.00	/
50		0.00	0.00
100		0.00	0.00
150		-	-
200		-	-
250	-	-	-
300	-	-	-
合 否 判 定: 合格・不合格			

発行番号	B9999999		
発行日	2021年9月13日		
<b>校正証明書</b>			
株式会社 OOOOOOOO 股			
品名	デジマチックキャリバ		
型式 / 符号	CD-15PS		
コード No.	500-622		
製造番号	\$\$\$\$\$\$		
製造者	株式会社ミツトヨ		
校正時の環境条件	温度20°C±3°C	湿度	70%以下
校正年月日	2021年9月10日		
検査成績書発行番号	A9999999		
校正に用いた標準器			
名称	符号	管理番号	有効期限
セラキャリバチェッカ	BB2	AA1	2022/6/30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
検査/校正結果は別紙検査成績書または校正結果の通りであることを証明します。			
栃木県宇都宮市平松本町367-9 株式会社MCS 宇都宮校正室 室長 福田 直行			
この校正証明書は国家標準または国際標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。 事前の承諾なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。			

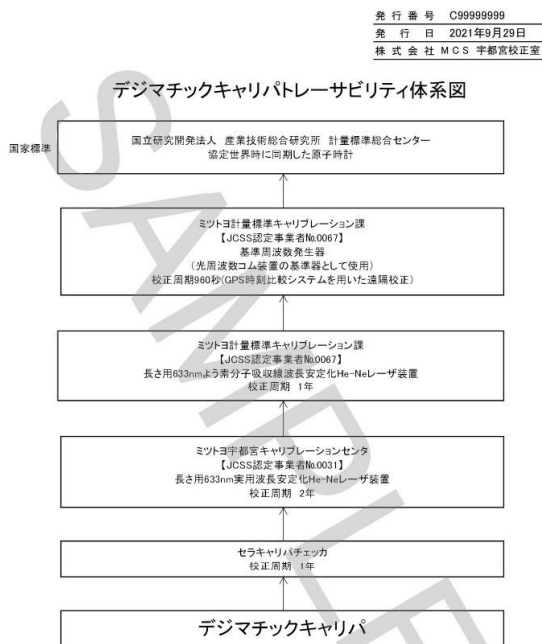

## 校正済シール サンプル