

		発行番号 B9999999	
		発行日 2023年1月26日	
検査成績書			
品名	標準形ダイヤルゲージ	検査年月日	2023年1月26日
符号	-	温度	20.0°C
コードNo.	2046A	湿度	50%
製造番号	\$\$\$\$\$\$	検査規格	ミツヨ規格
測定範囲	10mm		
目量	0.01mm		
性能	良		
検査結果	合格		

項目	許容指示誤差(μm)	誤差(μm)
1/10回転	5	2.1
1/2回転	9	3.2
1回転	10	5.3
全測定範囲	13	6.4

項目	許容値(μm)	実測値(μm)
戻り誤差	3	0.5
繰り返し精密度	3	0.6


		発行番号 A9999999
		発行日 2023年1月26日
校正証明書		
株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇 殿		
品名	標準形ダイヤルゲージ	
型式 / 符号	-	
コードNo.	2046A	
製造番号	\$\$\$\$\$\$	
製造者	株式会社ミツヨ	
校正時の環境条件	温度20°C±3°C	湿度70%以下
校正年月日	2023年1月26日	
検査成績書発行番号	B9999999	

校正に用いた標準器			
名称	符号	管理番号	有効期限
インジケータ検査機	IC2000	MDT01	2023/6/30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

検査/校正結果は別紙検査成績書または校正結果の通りであることを証明します。

栃木県宇都宮市平松本町367-9
 株式会社MCS 宇都宮校正室
 室長 福田 直行

この校正証明書は国家標準または国際標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。事前の承諾なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。

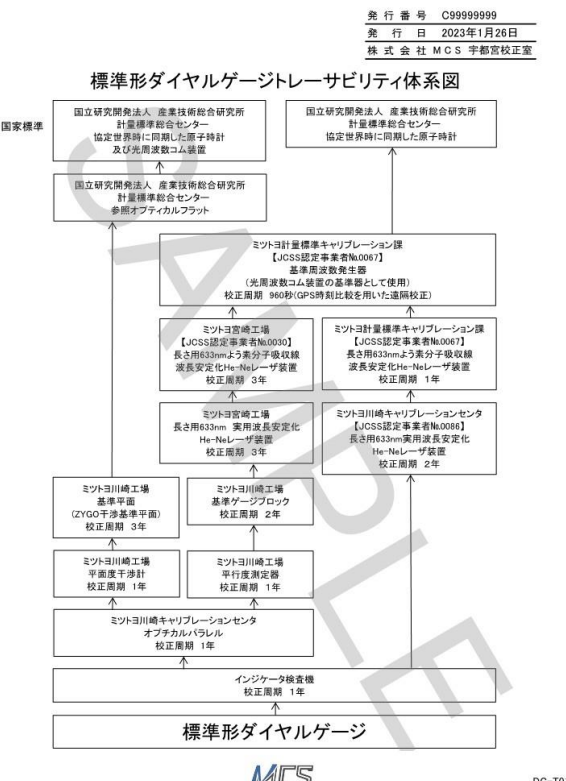

校正済シール
サンプル